

HCL information

報告下限値変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させて
いただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

●変更実施日 : 平成 30年 2月 5日 (月) 受付分～

●変更内容

案内書 掲載頁	項目 コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
P83	902	HBs抗体定性	報告下限値	(-)	(-)
P83	907	HBs抗体定量		2.5未満 (mIU/mL)	0.0 (mIU/mL)
P77	552	PIVKA-II		1以下 (mAU/mL)	1 (mAU/mL)




※HBs抗体定性およびPIVKA-IIは、試薬変更による内容変更はございません。

●変更理由 : 試薬変更の為



株式会社 兵庫県臨床検査研究所
本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492
岡山 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315

従来試薬との相関

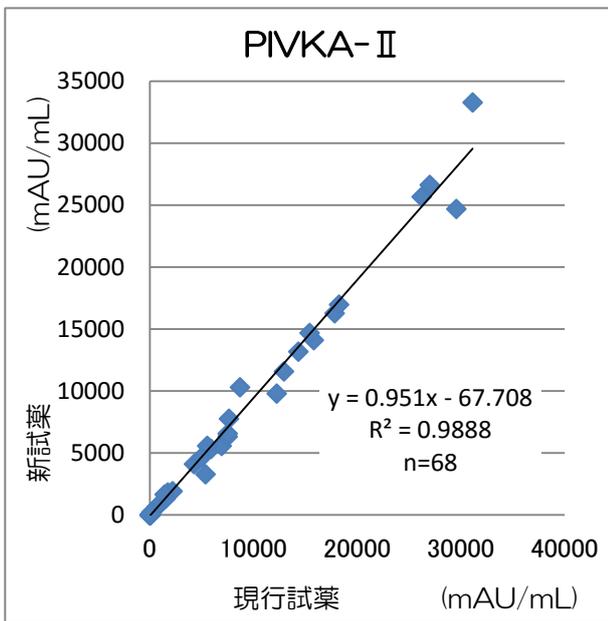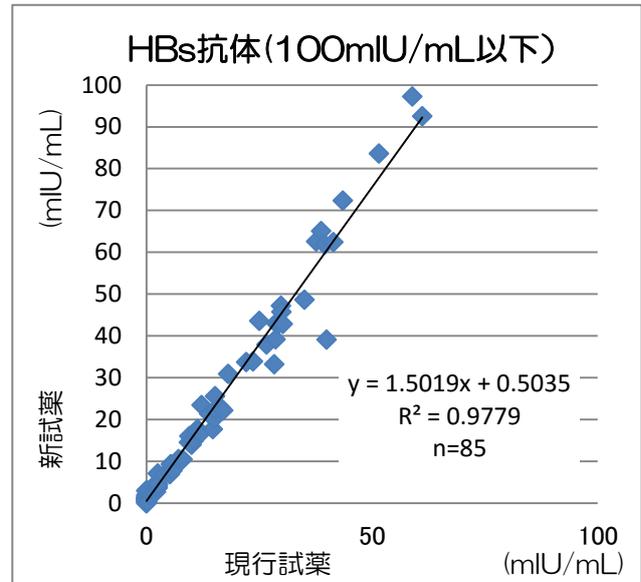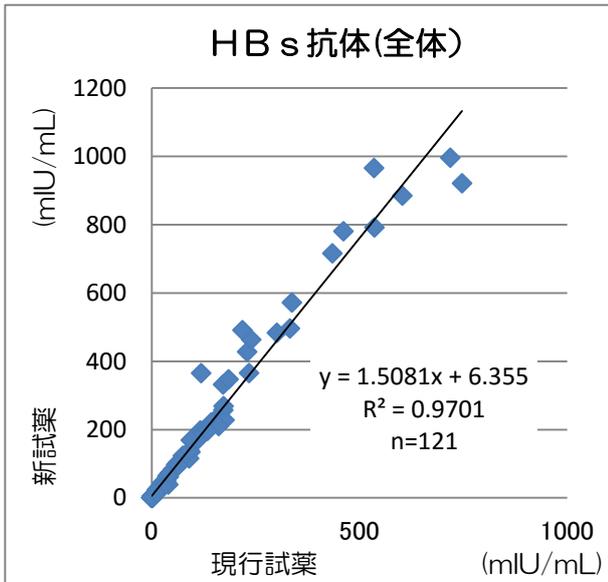

(社内検討データ)