

HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

●実施日 : 2020年 4月 1日(水) 受付分～

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
P2	0051	LD (LDH) (乳酸脱水素酵素)	検査方法	IFCC法	JSCC標準化対応法

※基準範囲等の変更はございません。

●変更理由 : 日本臨床化学会より、現行のJSCC常用基準法を国際臨床化学連合(IFCC)と同一の測定法に変更すると発表されたため

LD (IFCC法) の特徴

◆診断・治療の指針、病例報告、研究発表等において海外との相互利用が容易となります。
また、今後の国際的治験では、一般診療との二重の測定が不要となります。

(臨床化学会ホームページより参照)


※関連図は裏面参照



HCL 株式会社 兵庫県臨床検査研究所

姫路本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492 食品衛生管理MEL TEL : 079-267-1253
岡山支所 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315 病理検査室HPL TEL : 079-268-1101

● 相関図

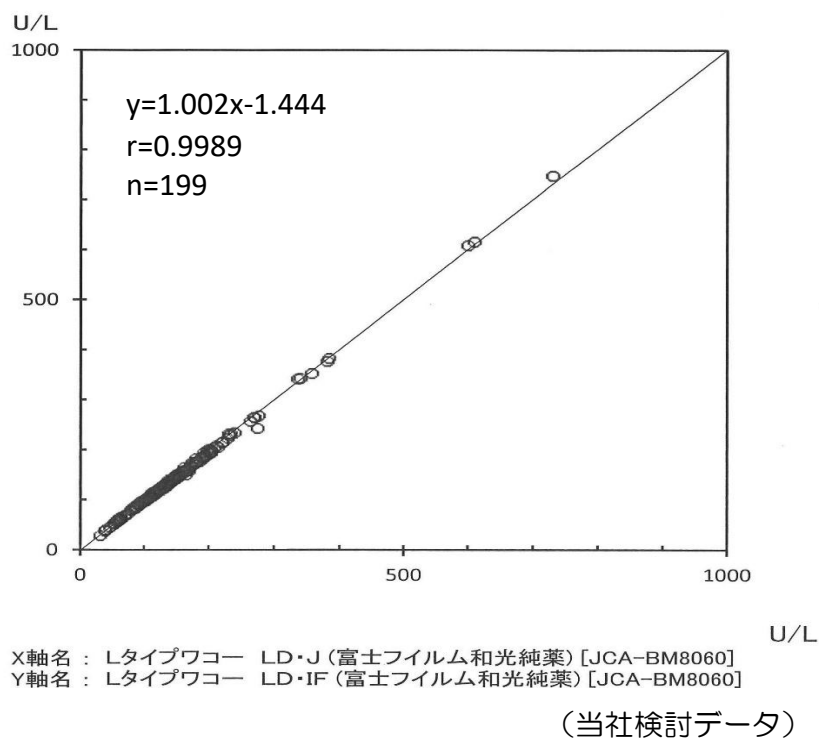

< 備考 >

- ◆ 試薬変更前後の測定値の差が軽微であり、健常者の測定値は許容誤差範囲内の変化であることから、現在の共用基準範囲を変更する必要はありません。
- ただし、LD5が増加することに従い、IFCC法では低めになることにご留意ください。
- (LD5が40%を超えるような検体ではIFCC法(新)よりJSCC法(旧)が10%~20%ほど高値となります。)

(臨床化学会ホームページより参照)