

HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、社内ルーチン
検査に変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記


●変更実施日 : 2021年 2月 16日(火) 受付分～

●変更内容

案内書 掲載頁	項目 コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P43	2350	シクロスポリン	検体量	血液 0.5mL	血液 0.7mL
			採取容器	B管 (EDTA-2K)	E10
			検査方法	CLIA法	ECLIA法
			報告桁数	少数第1位	整数
			所要日数	2～3日	3～5日
			委託先	社内検査	外注検査 (SRL)


※基準範囲の設定はございません。

●変更理由 : 社内検討による変更

 **HCL** 株式会社 兵庫県臨床検査研究所

姫路本社 TEL: 079-267-1251 神戸西支所 TEL: 078-929-0492 食品衛生管理MEL TEL: 079-267-1253
岡山支所 TEL: 086-952-5218 神戸東支所 TEL: 078-252-7315 病理検査室HPL TEL: 079-268-1101

●相関図（社内検討データ）

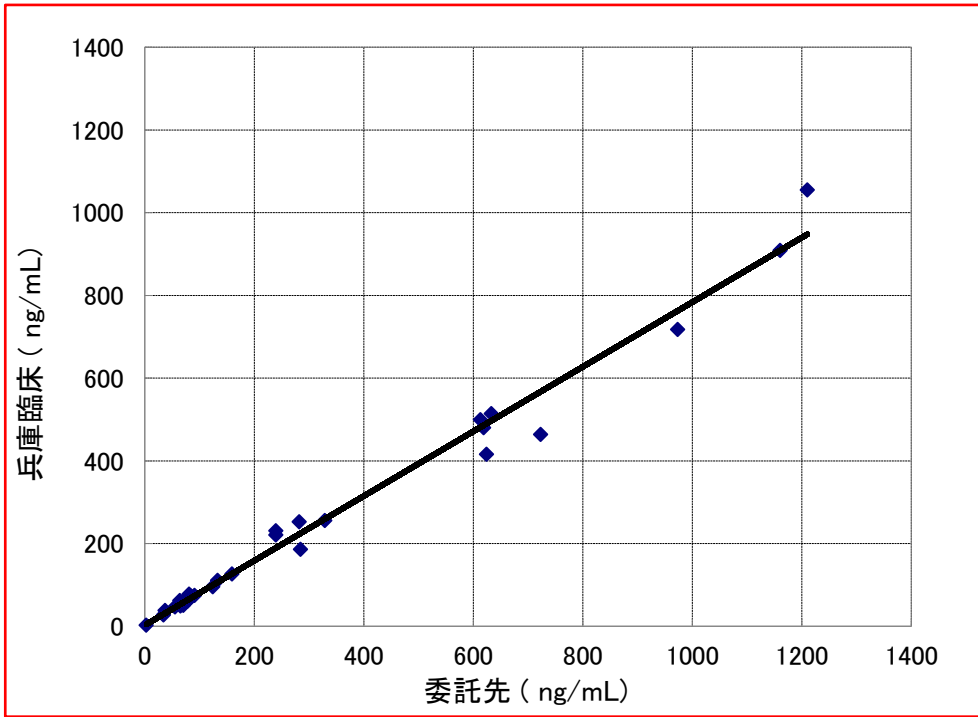

$$y=0.78x+2.43$$

$$r=0.992$$

$$n=30$$